

TURNED KEI

光触媒 除菌・脱臭機 / ターンド・ケイ

新型
コロナウイルス
99.8%
除去

インフルエンザ
ウイルス
99.9%
除去




新型コロナウイルスに対する
不活化効果が認められました

新型コロナウイルスの不活化効果

【試験結果-TCID₅₀法】

試験時間	光触媒+励起光					コントロール				
	0分	5分	10分	15分	20分	0分	5分	10分	15分	20分
感染力価 (TCID ₅₀ /ml) ※1	4.2×10^2	1.3×10^1	5.6	3.2	<1.33	5.6×10^3	2.4×10^3	1.3×10^3	1.8×10^3	1.3×10^3
対数減少値	—	0.5	1.875	2.125	>2.625	—	0.375	0.625	0.5	0.625
減少率 (%)	—	68.4	98.7	99.3	>99.8	—	57.8	76.3	68.4	76.3

※1 検出下限値：1.33 TCID₅₀/ml

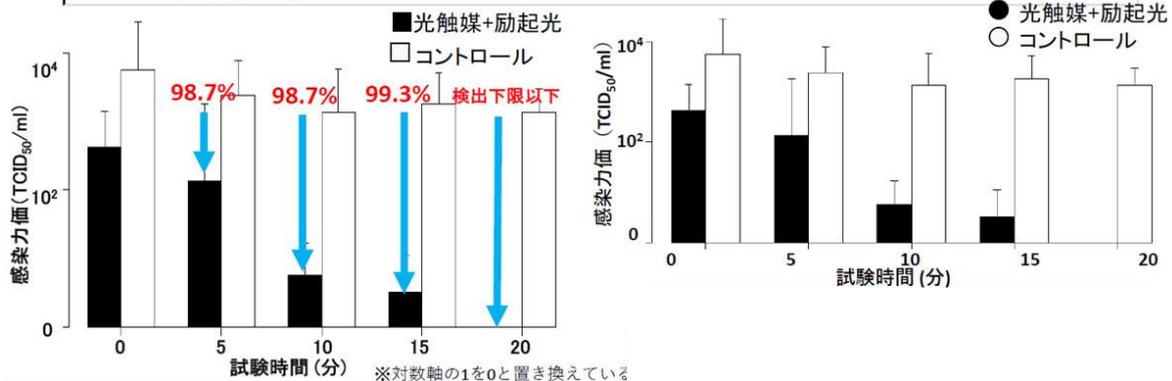

お問い合わせ先：フジックス株式会社 06-6762-3661